



Newgen Medicals NX4393-944 Fitnessarmband

Akku laden

1. Drehe das Armband, das dem EKG-Sensor gegenüberliegt, um 45°.

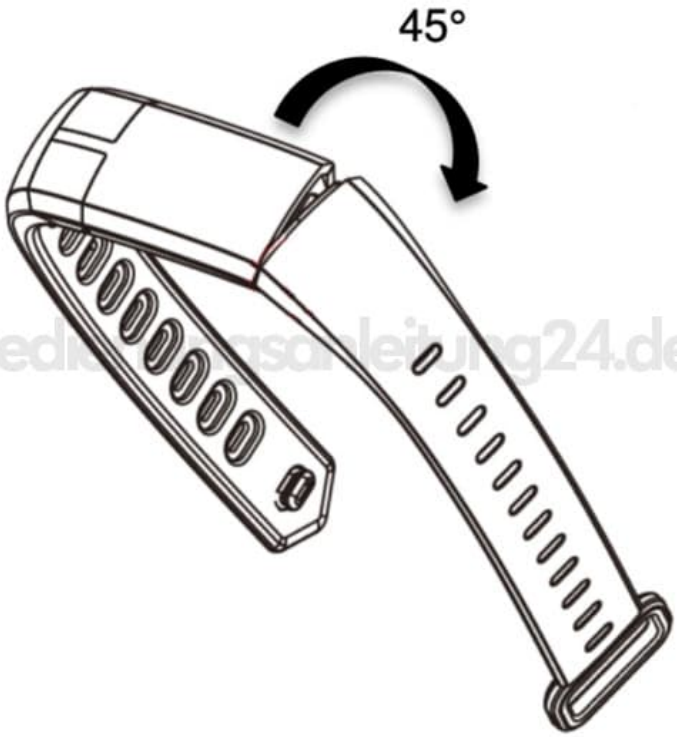

2. Ziehe es ab.

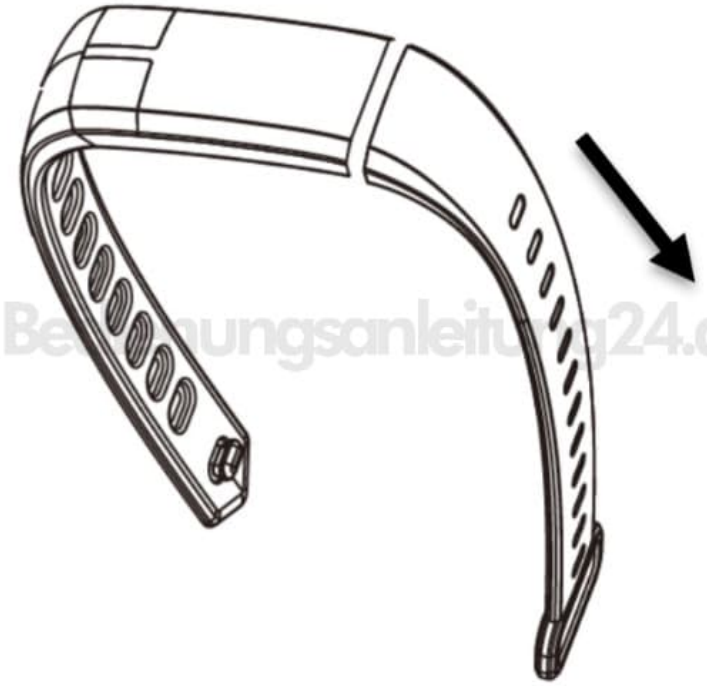

3. Verbinden Sie den freigelegten USB-Stecker mit einer geeigneten USB-Stromquelle; z.B. USB-Netzteil



4. Während des Ladevorgangs wird auf dem Display eine Lade-Animation angezeigt. Sobald diese stillsteht, ist der Akku vollständig geladen.

Hinweis: Das Display erlischt nach kurzer Zeit. Tippe kurz auf das Funktionsfeld, um das Display wieder einzuschalten und die Animation aufzurufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.